# 検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記検査項目におきまして、検査内容を変更させて頂くことになりましたのでご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

敬白

記

《検査項目》 〔0286〕 淋菌核酸同定検査 (PCR)

〔0281〕 クラミジア トラコマチス核酸同定検査(PCR)

〔4385〕 淋菌・クラミジア同時同定検査(PCR)


《変 更 日》 平成29年10月より順次変更

# 《変更内容》


検査 コード	検査項目	変更内容	変更後	変更前
0286	淋菌核酸同定検査(PCR)			
0281	クラミジア トラコマチス 核酸同定検査(PCR)	採取容器 形状 および セット内容	専用採取容器:70 スワブ(大)1 本 フロックスワブ1本	専用採取容器:70 スワブ(大)2本 スワブ(小)1本
4385	淋菌・クラミジア核酸同定 検査(PCR)			



## ◆ぬぐい液(子宮頸管)

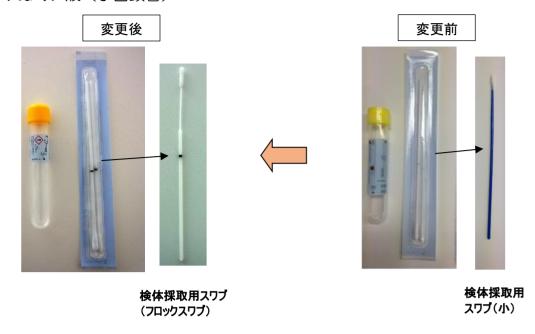

### ◆尿・うがい液

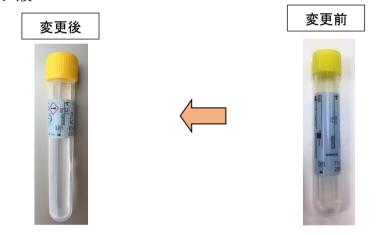

#### 変更箇所詳細

- 専用採取容器(コバス PCR メディア)のキャップ(蓋)の構造が改良され、色が濃い黄色になりました。
- 専用採取容器(コバス PCR メディア)のチューブの径が 1mm 程度細くなり、青ラベルが短くなりました。ラベルが短くなったことにより、メディア内の液量が見易くなります。
- 新製品に付属されているフロックスワブは、従来のスワブ(小)で検体採取した時と同等の感度を示し、 かつ太いスワブでの採取に比べて患者様への負担を軽減します。

メディア液の組成・内容量、ご使用上の運用方法に変更はございません。