

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、別掲の検査項目につきまして、検査内容を変更させて頂くことになりましたのでご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬 白

記

《変 更 日》平成 30 年 4 月 2 日（月）受付分より

《変更内容》詳細は別掲の一覧をご参照ください。



項目コード	検査項目	変更内容	変更後	変更前
3126	アルドラーゼ	基準値	2.7～5.9 IU/L	2.7～7.5 U/L
		単位	IU/L	U/L
2622	リゾチーム	基準値	5.0～10.0 μ g/mL	5.0～10.2 μ g/mL
		検体量	血清 0.3 mL	血清 0.5 mL
2618	ACE (アンギオテンシン I 転換酵素)	基準値	7.7～29.4 IU/L	7.0～25.0 U/L
		単位	IU/L	U/L
		所要日数	2～3	3～4
2616	CK-MB(CLIA)	基準値	7.5 ng/mL以下	5.0 ng/mL以下
		検体量	血清 0.6 mL	血清 0.5 mL
3120	アミラーゼアイソザイム	検査方法	電気泳動法(アガロース膜)	セルロース・アセテート膜電気泳動法
		基準値	P/S比 0.19～1.79 P型 15.7～64.0% S型 36.0～84.3%	P/S比 0.40～1.50 P型 30～60% S型 40～70%
3015	尿アミラーゼアイソザイム	基準値	P/S比 0.63～4.65 P型 38.7～82.3% S型 17.7～61.3%	P型 41～88% S型 12～59%
		検体量	尿 1.0 mL	尿 0.5 mL
2613	m-GOT	項目名称	m-AST	m-GOT
2560	アミノ酸分析	報告形態	最終ページ参照	
2899	アミノ酸分析 9種	項目名称	アミノ酸 分析11種	アミノ酸分析 9種
		報告項目	バリン、メチオニン、イソロイシン、ロイシン、チロシン、フェニルアラニン、オルニチン、ヒスチジン、リジン、トリプトファン、アルギニン 以上11種	バリン、メチオニン、イソロイシン、ロイシン、チロシン、フェニルアラニン、ヒスチジン、リジン、アルギニン 以上9種
2541	ケトン体分画	基準値	総ケトン体 26～122 アセト酢酸 13～69 3-ハイドロキシ酪酸 76以下 μ mol/L	総ケトン体 130 以下 アセト酢酸 55 以下 3-ハイドロキシ酪酸 85以下 μ mol/L
3117	ビタミンA	基準値	27.2～102.7 μ g/dL	97～316 IU/dL
		単位	μ g/dL	IU/dL
		検体量	血清 0.3 mL	血清 0.4 mL
		保存条件	凍結(遮光)	冷蔵(遮光)
2573	ビタミンB2	検査方法	蛍光法(ルミフラビン蛍光法)	HPLC法
		検体量	全血 1.1 mL	全血 0.5 mL
		基準値	4.1～8.8 μ g/dL	66.1～111.4 ng/mL
		単位	μ g/dL	ng/mL
3080	カルニチン分画	項目名称	カルニチン	カルニチン分画
		所要日数	3～4	5～8
2630	血清亜鉛	基準値	64～111 μ g/dL	59～135 μ g/dL
2970	アルミニウム	基準値	0.9 μ g/dL以下	16 μ g/L以下
		単位	μ g/dL	μ g/L

項目コード	検査項目	変更内容	変更後	変更前
2664	結石分析(比率)	報告形態	最終ページ参照	
2855	プリミドン	検査方法	EMIT法	EIA法
		検体量	血清 0.3 mL	血清 0.5 mL
4699	TSHレセプター抗体定量(ECLIA)	報告下限	0.8 IU/L未満	0.3 IU/L未満
3096	TSH刺激性レセプター抗体	検査方法	Bioassay法+EIA法	EIA法
		保存条件	凍結	冷蔵
3339	骨型アルカリホスファターゼ	検体量	0.3 mL	0.8 mL
		保存条件	凍結	冷蔵
4119	血清NTX 骨粗鬆症	検体量	血清 0.6 mL	血清 0.3 mL
4026	尿中NTX 骨粗鬆症	検体量	尿 2.0 mL	尿 3.0 mL
		保存条件	凍結	冷蔵
4488	TRACP-5b	検体量	血清 0.3 mL	血清 0.5 mL
2702	17-KS7分画	基準値	下記参照	下記参照
		検体量	蓄尿 5 mL	蓄尿 12 mL
2715	11-OHCS	基準値	5.0~21.4 $\mu\text{g/dL}$ (午前8時~10時採血)	7.0~23.0 $\mu\text{g/dL}$ (午前10時採血)
		検体量	血清 2.1 mL	血清 0.5 mL
2558	DHEA-S	基準値	下記参照	下記参照
		単位	$\mu\text{g/dL}$	ng/mL
		保存条件	冷蔵	凍結
2637	アンドロステロン	検体量	血清 0.5 mL	血清 1.0 mL
		保存条件	冷蔵	凍結
2685	尿中カテコールアミン3分画	基準値	A 1.1~ 22.5 NA 29.2~ 118 DA 100 ~1,000 $\mu\text{g/day}$	A 3.0~ 41.0 NA 31.0~ 160.0 DA 280.0~1100.0 $\mu\text{g/day}$
4484	尿メタネフリン2分画CRE補正	単位	ng/mg・CRE	mg/g・CRE
2689	セロトニン(血漿)	基準値	623 ng/mL以下	0.04~0.35 $\mu\text{g/mL}$
		単位	ng/mL	$\mu\text{g/mL}$
		検体量	0.6 mL(多血小板血漿)	血漿 1.5 mL
2692	尿中5-HIAA	基準値	0.6~4.1 mg/day	1.0~6.0 mg/day
		保存条件	冷蔵	凍結
3074	遊離テストステロン	検査方法	RIA法(チューブ固相法)	EIA法
		基準値	下記参照	下記参照
2930	アンギオテンシン II	基準値	50 pg/mL以下	22 pg/mL以下
		検体量	血漿 0.6 mL	血漿 0.3 mL
		所要日数	8~13	6~8

○ 17-KS 7分画基準値

	変更後	変更前
男性	アンドロステン 1.12 ~ 4.71	1.10 ~ 4.20
	エチオコラノン 0.43 ~ 3.23	0.55 ~ 2.60
	デヒドロエピアンドロステロン 2.92以下	0.12 ~ 5.20
	11-ケトアンドロステロン 0.50以下	0.12以下
	11-ケトエチオコラノン 0.08 ~ 0.63	0.04 ~ 0.65
	11-OHアンドロステロン 0.39 ~ 2.04	0.40 ~ 2.30
	11-OHエチオコラノン 0.54以下	0.03 ~ 0.65
女性	アンドロステン 0.22 ~ 2.78	0.40 ~ 3.00
	エチオコラノン 0.10 ~ 2.39	0.30 ~ 2.50
	デヒドロエピアンドロステロン 1.49以下	0.04 ~ 2.60
	11-ケトアンドロステロン 0.48以下	0.07以下
	11-ケトエチオコラノン 0.62以下	0.03 ~ 0.50
	11-OHアンドロステロン 0.19 ~ 1.17	0.22 ~ 1.60
	11-OHエチオコラノン 0.75以下	0.02 ~ 0.65

(mg/day)

○ DHEA-S基準値


	年齢(歳)	測定値($\mu\text{g/dL}$)
男性	20~29	159 ~ 538
	30~39	125 ~ 475
	40~49	123 ~ 422
	50~59	76 ~ 386
	20~29	92 ~ 399
	30~39	58 ~ 327
	40~49	41 ~ 218
女性	50~59	30 ~ 201
	18~20	240 ~ 5370
	21~30	850 ~ 6900
	31~40	1060 ~ 4640
	41~50	700 ~ 4950
	51~60	380 ~ 3130
	61~70	240 ~ 2440
女性	71以上	50 ~ 2530
	18~20	510 ~ 3210
	21~30	180 ~ 3910
	31~40	230 ~ 2660
	41~50	190 ~ 2310
	51~60	80 ~ 1880
	61~70	120 ~ 1330
	71以上	70 ~ 1770

○ 遊離テストステロン基準値

	年齢(歳)	測定値(pg/mL)
男性	20~29	7.6 ~ 23.8
	30~39	6.5 ~ 17.7
	40~49	4.7 ~ 21.6
	50~59	4.6 ~ 19.6
	60~69	5.3 ~ 11.5
	70~	4.6 ~ 16.9
	20~29	0.4 ~ 2.3
女性	30~39	0.6 ~ 2.5
	40~49	0.3 ~ 1.8
	50~	0.8 ~ 1.7
	20~29	8.8 ~ 31.7
	30~39	7.3 ~ 28.9
	40~49	6.2 ~ 24.9
	50~59	6.1 ~ 25.0
女性	60~80	5.8 ~ 18.2
	20~29	1.5 ~ 4.9
	30~39	0.8 ~ 4.1
女性	40~49	0.5 ~ 4.0
	50~59	未設定
	60~80	未設定

項目コード	検査項目	変更内容	変更後	変更前
2549	レチノール結合タンパク	検査方法	LA法	ネフェロメトリー法
		基準値	男 2.7～6.0 女 1.9～4.6 mg/dL	2.5～7.1 mg/dL
		検体量	血清 0.3 mL	血清 0.5 mL
4352	シスタチンC	基準値	男 0.61～1.00 女 0.51～0.82 mg/L	男 0.58～0.87 女 0.47～0.82 mg/L
		検体量	血清 0.3 mL	血清 0.5 mL
2547	クリオグロブリン定性	検体量	血清 0.3 mL	血清 2.0 mL
2647	α 2マクログロブリン	検体量	血清 0.4 mL	血清 0.3 mL
226	血清補体価(CH50)	基準値	30～46 CH ₅₀ /mL	30.0～50.0 U/mL
		単位	CH ₅₀ /mL	U/mL
2639	IgD	基準値	12.6 mg/dL以下	9.0 mg/dL以下
2889	PAIgG	基準値	30.2 ng/10 ⁷ cells以下	27.6 ng/10 ⁷ PLT未満
		単位	ng/10 ⁷ cells	ng/10 ⁷ PLT
		保存条件	冷蔵	室温
		採取容器	下記参照	下記参照
2767	抗平滑筋抗体	基準値	20倍未満	40倍未満
3232	抗カルジオリピン抗体 IgG	検体量	血清 0.4 mL	血清 0.2 mL
		桁数	小数第一位	整数

○ PA-IgG 採取容器

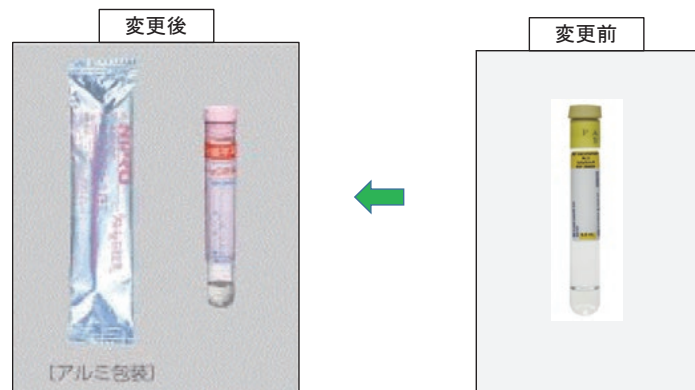


項目コード	検査項目	変更内容	変更後	変更前
2509	水帯ヘルペスIgG(EIA)	検体量	血清 0.6 mL	血清 0.3 mL
2510	水帯ヘルペスIgM(EIA)	検体量	血清 0.6 mL	血清 0.3 mL
3042	HTLV-1(ATLV) (ウエスタンブロット法)	検体量	血清 0.6 mL	血清 0.3 mL
		所要日数	4～10	4～6
3177	クラミジア ニューモニエ抗体 IgG	項目名称	クラミドフィラ・ニューモニエ抗体 IgG	クラミジア・ニューモニエ抗体 IgG
		基準値	(－) カットオフインデックス： 1.0未満	(－) カットオフインデックス： 0.900未満
		桁数	小数第一位	小数第三位
		検体量	血清 0.6 mL	血清 0.3 mL
3289	クラミジア ニューモニエ抗体 IgA	項目名称	クラミドフィラ・ニューモニエ抗体 IgA	クラミジア・ニューモニエ抗体 IgA
		基準値	(－) カットオフインデックス： 1.0未満	(－) カットオフインデックス： 0.900未満
		桁数	小数第一位	小数第三位
		検体量	血清 0.6 mL	血清 0.3 mL
3362	クラミジア ニューモニエ抗体 IgM	項目名称	クラミドフィラ・ニューモニエ抗体 IgM	クラミジア・ニューモニエ抗体 IgM
		基準値	(－) カットオフインデックス： 0.90未満	(－) カットオフインデックス： 0.900未満
		桁数	小数第二位	小数第三位
		検体量	血清 0.5 mL	血清 0.3 mL
2845	クラミジア シッタシ抗体 IgG	項目名称	クラミドフィラ・シッタシ抗体 IgG	クラミジア シッタシ抗体 IgG
2846	クラミジア シッタシ抗体 IgM	項目名称	クラミドフィラ・シッタシ抗体 IgM	クラミジア シッタシ抗体 IgM
2913	オウム病クラミジア (クラミジア・シッタシ抗体)	項目名称	オウム病抗体 (クラミドフィラ・シッタシ抗体)	オウム病クラミジア (クラミジア・シッタシ抗体)
1824	HBc抗体－IgM	検体量	血清 0.5 mL	血清 0.3 mL
		桁数	小数第一位	小数第二位
	リンパ球表面マーカー検査※	報告形態	最終ページ参照	
2879	CD4	基準値	29～55%	25.0～54.0%
2880	CD8	基準値	19～41%	23.0～56.0%
3153	I 型コラーゲンCテロペプチド	基準値	5.5 ng/mL未満 (骨転移判定のcut off値)	4.5 ng/mL未満

※ 表中の項目以外も同様に変更となります。


項目コード	検査項目	変更内容	変更後	変更前
2923	尿中FDP定量	検査方法	LA法	LPIA法
		基準値	0.1 μ g/mL以下	100ng/mL以下
		単位	μ g/mL	ng/mL
		検体量	新鮮尿 1 mL	新鮮尿 2 mL
		保存条件	冷蔵	凍結
		採取容器	下記参照	下記参照
3014	プラスミノゲン	項目名称	プラスミノゲン活性	プラスミノゲン
		基準値	80～130 %	75～125 %
		検体量	血漿 0.3 mL	血漿 0.5 mL
2665	アンチトロンビンⅢ活性(AT-Ⅲ)	項目名称	アンチトロンビン活性(AT活性)	アンチトロンビンⅢ活性(AT-Ⅲ)
3002	TAT (トロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体)	検体量	血漿 0.5 mL	血漿 0.4 mL
		基準値	3.0 ng/mL未満	4.0 ng/mL未満
2605	プロテインC(抗原量)	検査方法	LA法	LPIA法
2546	プロテインC活性	検査方法	合成基質法	凝固時間法
		基準値	70～140 %	64～146 %
		検体量	血漿 0.3mL	血漿 0.4mL
2736	プロテインS(抗原量)	備考	備考削除	遊離型抗原量を測定
3324	プロテインS活性	基準値	64～149 %	男 67～164 % 女 56～126 %
3029	第ⅩⅢ因子定量(F13)	項目名称	第ⅩⅢ因子定量(F13)	第ⅩⅢ因子(抗原量)(F13)
		基準値	70 %以上	70～140 %
	先天異常、血液疾患染色体検査※	報告形態	最終ページ参照	
2892	先天異常染色体G-BANDING			
2894	血液染色体G-BANDING			
4376	IgGサブクラス IgG4	基準値	4.8～105 mg/dL	5～117 mg/dL
		検体量	血清 0.4mL	血清 0.5mL

※ 表中の項目以外も同様に変更となります。

○ 尿FDP定量 採取容器

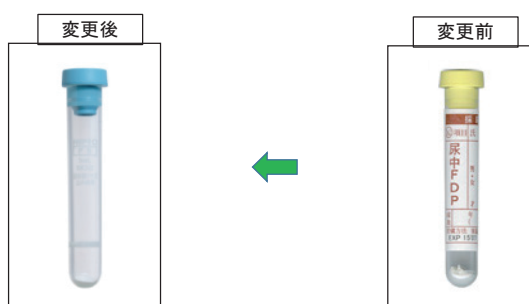


◎結石分析

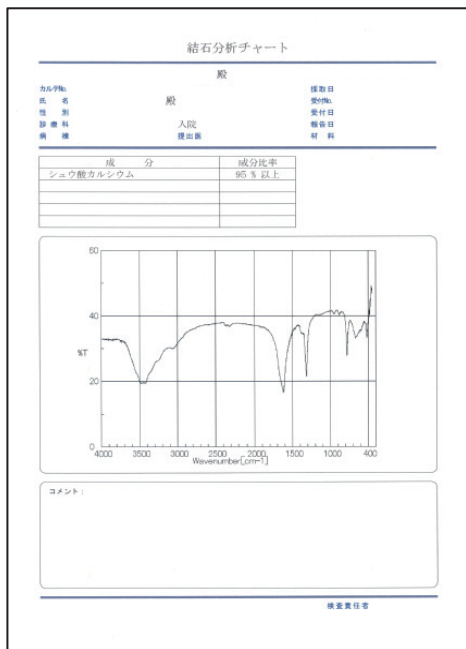

◎リンパ球サブセット



◎アミノ酸分画

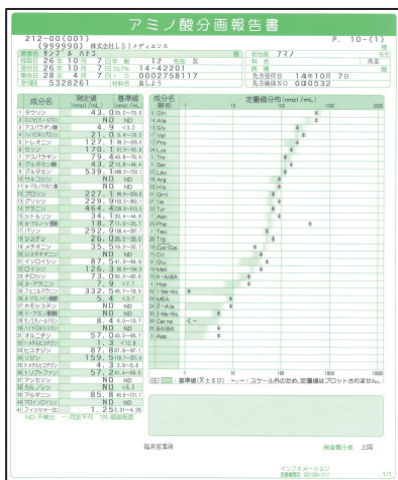

◎血液疾患染色体検査

