平成 27 年 11 月

検査内容変更のご案内

謹啓　時下益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、かねてより検討を進めておりました下記検査項目につきまして、検査所要日数が短縮可能となりましたのでお知らせ申し上げます。なお、HBs 抗体(精密)につきましては、検査方法を変更させていただきます。その他、検体量・保存条件・基準値に変更はございません。

今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

敬　白

記

《検査項目》　〔2205〕　HBs 抗体（精密）
〔4184〕　便中ヒトヘモグロビン定量

《変 更 日》　平成 27 年 11 月 24 日（火）受付分より

《変更内容》

検査コード	検査項目	変更内容	変更後	変更前
2205	HBs抗体(精密)※1	所要日数	2～3	3～5
		検査方法	ECLIA法	CLIA法
4184	便中ヒトヘモグロビン定量	所要日数	2～3	4～5

その他、検体量・保存条件・基準値に変更はございません。

※1：HBs 抗体(精密)の相関図・一致率は、裏面をご参照ください。

アルプ

《相関図》

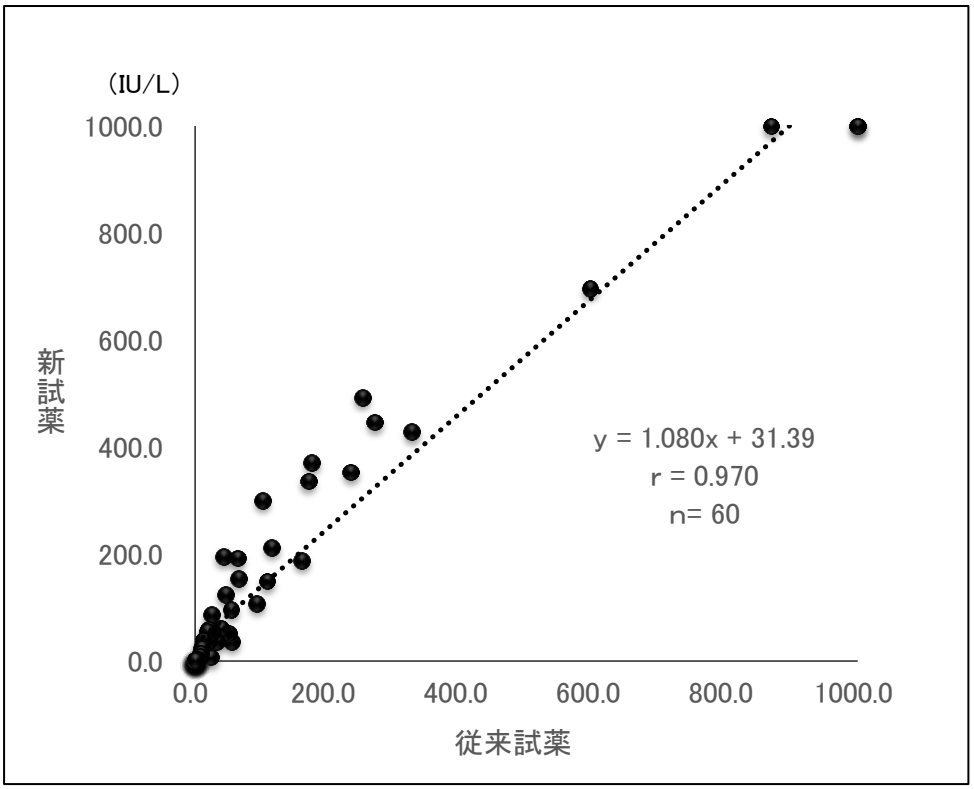

《従来試薬との比較》

		従来試薬		計
		（－）	（＋）	
新試薬	（－）	25	1	26
	（＋）	1	41	42
計		26	42	68

判定一致率:　97.1%