

## ウイルス遺伝子検査用容器(A-5) 変更のご案内

謹啓 時下益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、容器を変更させて頂くことになりましたのでご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。


敬 白

### 記

《変更容器》 A-5：ウイルス遺伝子検査用容器

《変更日》 在庫状況に応じて順次変更

《変更内容》

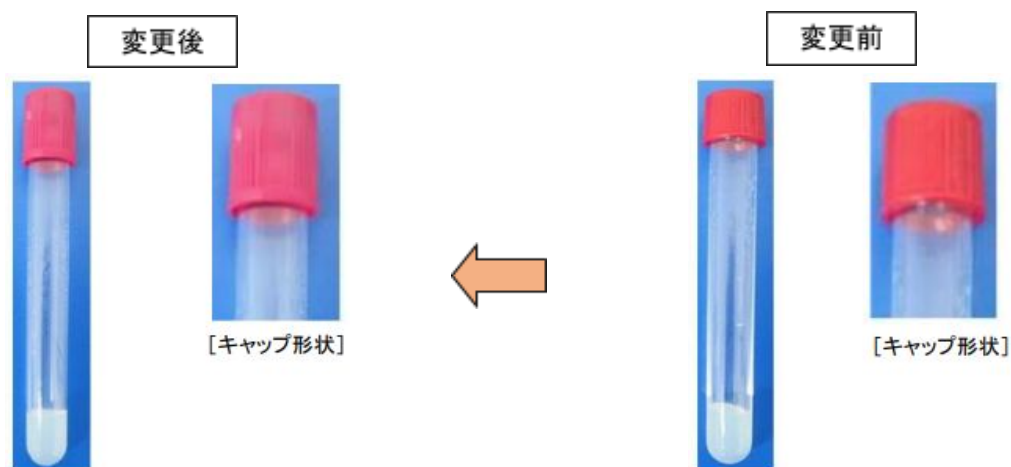

### [変更内容]

- ・キャップ形状および金型が変更になりましたが、材質については変更ありません。
- ・氏名ラベルは、従来通り貼付されています。
- ・凝固剤および分離剤に変更はありません。
- ・梱包数が、50本（トレー）入りから100本（箱）入りに変更されました。  
※従来通り、少数でもお届け致します。