

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、下記検査項目におきまして日本性感染症学会推奨の自動化法（ラテックス比濁法）に変更させて頂くことになりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

敬白

記

《検査項目》

- 〔00259〕 T P H A 定性
- 〔00264〕 R P R 定性
- 〔00263〕 T P H A 定量
- 〔00275〕 R P R 定量
- 〔02599〕 髄液梅毒 T P H A 定性
- 〔02601〕 髄液梅毒 T P H A 定量

《変更日》 2025年 12月 1日（月）受付分より

《変更内容》

検査コード	検査項目	変更箇所	変更後	変更前
00259	TPHA定性	項目コード	03988	00259
		項目名称	TP抗体定性(LA)	TPHA定性
		検査方法	LA法	PA法
		報告様式	(-),(+)	陰性, 疑陽性, 陽性
		基準値	(-)	陰性
00264	RPR定性	項目コード	03989	00264
		項目名称	RPR定性(LA)	RPR定性
		検査方法	LA法	凝集反応
		報告様式	(-),(+)	陰性, 疑陽性, 陽性
		基準値	(-)	陰性

裏面に続く

《変更内容》

検査コード	検査項目	変更箇所	変更後	変更前
00263	TPHA定量	項目コード	06623	00263
		項目名称	TP抗体定量(LA)	TPHA定量
		検体量	血清 0.3mL	血清 0.5mL
		検査方法	LA法	PA法
		基準値	10.0未満	80未満
		単位	T.U.	倍
		報告下限値	5.0未満	80未満
00275	RPR定量	項目コード	06676	00275
		項目名称	RPR定量(LA)	RPR定量
		検体量	血清 0.3mL	血清 0.5mL
		検査方法	LA法	凝集反応
		基準値	1.0未満	1未満
		単位	R.U.*	倍
		報告下限値	0.2未満	1未満
02599	髄液梅毒TPHA定性	項目名称	髄液梅毒TP抗体定性(LA)	髄液梅毒TPHA定性
02601	髄液梅毒TPHA定量	項目名称	髄液梅毒TP抗体定量(LA)	髄液梅毒TPHA定量

* 1R. U. はRPRカード法の1倍に相当します。

梅毒検査ではまれに非特異的に抗体が産生され、生物学的偽陽性反応（BFP）を示す場合がございます。

測定結果に基づく診断は他の関連検査や臨床症状を考慮して総合的にご判断下さい。

《新旧比較表》

《TP抗体定性》

		従来法	
		+	-
新法	+	91	9
	-	1	119


(N=220)

《RPR定性》


		従来法	
		+	-
新法	+	57	40
	-	6	116

(N=219)

《TP抗体定量》 ※参考資料

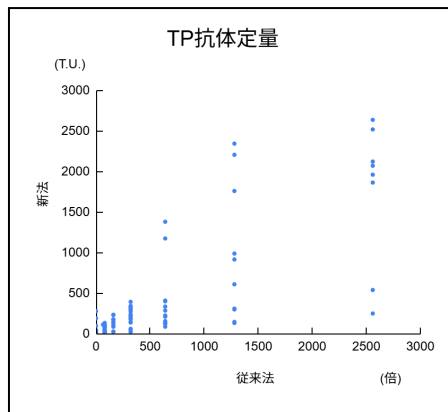

《RPR定量》 ※参考資料

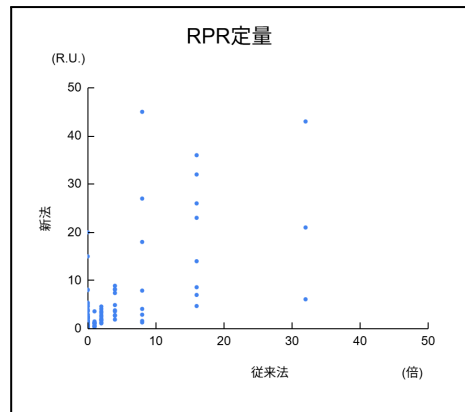

(社内検討データ)